
Kurzanweisung

redsnap.pole-light

redsnap.rail-light

Diese Kurzanweisung ersetzt nicht die Gebrauchsanweisung des redsnap!

© Jede Veröffentlichung dieser Anweisung (auch auszugsweise) bedarf der schriftlichen Genehmigung der hestomed GmbH.

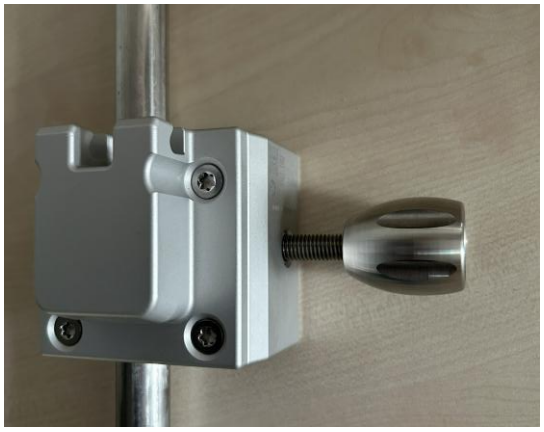



Hersteller

hestomed GmbH
Kauffahrtei 25, Haus 1
D09120 Chemnitz
Deutschland

Revision: 01a vom 2026-10-15

Sicherheitsinformationen

	**Das Produkt darf nur von autorisiertem Personal bedient werden.**
	Verboten ist die Nutzung des redsnap.rail-light oder des redsnap.pole-light durch Anwender, die nicht mit der sicheren Handhabung des Produktes vertraut sind. Jeder Anwender muss sich vor der Verwendung mit den Bedienelementen und Funktionen des redsnap.rail-light oder des redsnap.pole-light vertraut machen. Das redsnap ist nicht zu verwenden, wenn es wegen einer Beschädigung nicht oder nicht vollständig funktionsfähig sein sollte.
	Patienten-, Anwender-, und Geräteschäden werden dadurch verhindert.

	**Die Verlastung eines Gerätes während der Fahrt am redsnap.pole-light oder am redsnap.rail-light ist nicht zulässig!**
	Die Verbindung zwischen Rundrohr und Rundrohrklemme und die Verbindung zur geräteseitigen Halterung ist nicht nach DIN EN 1789 getestet.
	Es besteht die Gefahr, dass im Falle eines Unfalles das Gerät löst und Anwender oder Patienten durch herumfliegende Teile zu Schaden kommen.

	**Die Gebrauchsanweisungen des jeweiligen Herstellers der kombinierten Produkte sind zu beachten.**
	Die Nutzung der Produkte und Medizinprodukte ist nur sicher, wenn die einschlägige Gebrauchsanweisung des jeweiligen Herstellers berücksichtigt wird.
	Patienten- und Geräteschäden werden dadurch verhindert.

Begriffe, Symbole und Erklärungen

Verweis: Gebrauchsanweisung redsnap


Spezifische Ergänzung zur bestimmungsgemäßen Verwendung gemäß Gebrauchsanweisung redsnap

Das redsnap.pole-light und das redsnap.rail-light sind Varianten ohne Arretietungsmechanismus zur Verriegelung. Die light Varianten des redsnap dienen ausschließlich dem Gerätetransport an einer Fahrtrage. Das redsnap.pole-light und das redsnap.rail-light sind nicht geeignet für die Befestigung von Geräten während der Fahrt eines Rettungsfahrzeuges.

Die Befestigung an Rundrohr oder Normschiene erfolgt entsprechend der Beschreibung zum redsnap.pole und zum redsnap.rail.

.

Aufbau und Systembestandteile

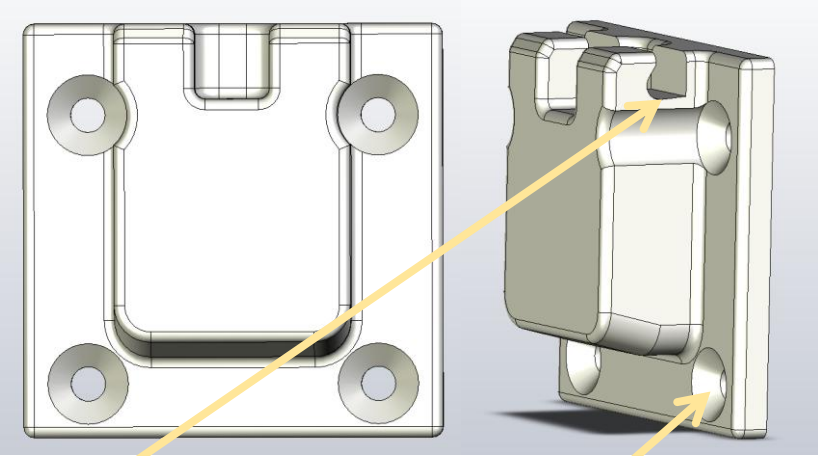

Aufnahme für Schwenkachse

redsnap light mit 4 Stück M6 Befestigungsschrauben
(zur Verwendung vormontiert)

Verwendung

Das Einhängen des Gerätes in das redsnap.pole-light oder redsnap.rail-light erfolgt wie in der Gebrauchsanweisung zum redsnap beschrieben. Nach dem Loslassen des eingehängten Gerätes erfolgt jedoch keine Verriegelung. Das eingehängte Gerät wird ausschließlich durch die Schwerkraft gehalten.

Beim Entnehmen des Gerätes muss keine Entriegelung betätigt werden, das Gerät wird aus der unteren Position ausgeschwenkt und nach oben aus der Schwenkachse herausgehoben.

Anleitung zur Installation des redsnap.pole-light redsnap.rail-light

	**Installation nur durch qualifizierte Anwender**
	Bei nicht fachgerechter Installation besteht die Gefahr, dass sich die Halterung von der Wand löst und Anwender oder Patienten durch herumfliegende Teile zu Schaden kommen.
	Die Installation des redsnap.pole darf ausschließlich durch Personen vorgenommen werden, die die notwendige Kraft aufbringen können, um das redsnap.pole sicher auf der Normschiene zu befestigen.

Die Installation des redsnap.pole-light erfolgt entsprechend der spezifischen Anweisung zum redsnap.pole.
Die Installation des redsnap.rail-light erfolgt entsprechend der spezifischen Anweisung zum redsnap.rail.

Erforderliches Werkzeug:

kein Werkzeug erforderlich

Hygienische Aufbereitung

Die hygienische Aufbereitung ist in der Gebrauchsanweisung des redsnap beschrieben.

Prüfung, Wartung und Instandsetzung

Es sind die Angaben dazu in der Gebrauchsanweisung redsnap zu beachten.

Gewährleistung und Haftung

Es gelten die Bedingungen, die in der redsnap Gebrauchsanweisung festgelegt sind.

Lebensdauer & Entsorgung

Es gelten die Festlegungen, die in der redsnap Gebrauchsanweisung festgelegt sind.

Technische Daten

	hestomed GmbH Kauffahrtei 25, Haus 1 09120 Chemnitz Germany	info@hestomed.de +49 371 646145-0 redsnap.eu
Warenanlieferung und -abholung	hestomed GmbH Hildegard-Helbig-Straße 5 74259 Widdern Germany	+49 6298 3753-100 +49 6298 3753-144
REF	redsnap.pole-light redsnap.rail-light	redsnap5-§-light-pole-§ redsnap5-§-light-rail-§ (§ kennzeichnet herstellerspezifische Revisionsstände)

Abmessungen [mm]:	redsnap.pole-light redsnap.rail-light	130 x 80 x 80 (Breite x Höhe x Tiefe) 80 x 125 x 65 (Breite x Höhe x Tiefe)
Lager- und Betriebsbedingungen: (transiente Bedingungen gemäß DIN EN 60601-1-12)		-20°C bis 50°C
		620 hPa bis 1060 hPa
		15% bis 90% nicht kondensierend
Masse [g]:	redsnap.pole-light redsnap.rail-light	680g 580g
Material:	EN AW-5754 AlMg3	
Oberfläche:	mechanische Teile: Aluminium natur eloxiert, Griffspindel A2	
Schrauben:	A2 070 mit TufLok®	
Zulassungen (konform):	REACH konform	
	RoHS konform	

Ersatzteile

	Grundkörper_light (10305-260366-100-001-a)
	Poleklemme (10305-250549-100-000)
	Railklemme (10305-250002-100-000)
	1VE 4 Stück Verbindungsschrauben M6x12 A2 ISO14581 T30 mit TufLok®